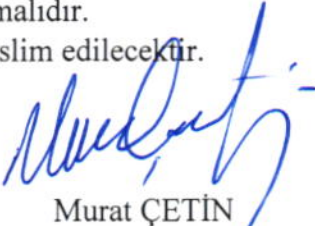


TEK KULLANIMLIK MASKE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yırtılmaya dayanıklı, kolay alev almayan, 3 katlı, 1. Katman spunbond 30g, 2. katman **(orta katman) Meltblown** 25g, 3'ncü katman spunbond 20g olacak şekilde yapılmış olmalıdır.
2. Bakterilere, virüslere ve mikroskobik partiküllere karşı koruma sağlar özellikte olmalıdır.
3. Maskenin burun üzerine gelen kısmında en az 9 cm uzunluğunda şekillendirilebilir gizli tel desteği bulunmalıdır.
4. Maske kanallarında boşluk olmamalıdır. Ağız ve burnu tümüyle kaplamalı, yüz kıvrımlarına uygun olmalı ve en az 3 körüklü olmalıdır.
5. Rahat nefes alınabilmelidir. Böylelikle nemin tek noktada yoğunlaşmasına mani olacak yapıya sahip olmalı ve terletmemelidir. Rahatsız edici kokusu olmamalıdır. Tüülenmemelidir.
6. Hipoallerjik olmalı, cam elyaf, lateks ve fiberglas içermemelidir.
7. Mavi veya beyaz renkte olmalıdır.
8. Lastikleri **sağlam/kopmayan** şekilde yeni nesil lycra kumaş olmalıdır.
9. Lastik uzunlukları eşit olmalı, uzunluğu en az 18 cm, en fazla 22cm, lastik eni en az 1.5cm olmalıdır.
10. Maskeler orijinal kutularda 50 adet olmalıdır.
11. Koli içi 50 paketli olmalı, Kutu ölçüleri 20 cm uzunluk, 10 cm en ve 10 cm yüksekliğinde olmalıdır.
12. Sağlık Bakanlığı ürün takip sistemine kayıtlı ve Ürün standart ve yönetmeliklerine uygun, TS EN 14683 standardına ve CE işaretine sahip olmalıdır.
13. Ürünler Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına teslim edilecektir.


Murat ÇETİN
İş Sağlığı ve Güvenliği
Şube Müdürü

Buket ERGİN
Çevre Koruma ve Kontrol
Daire Başkanı
